TERRAGENE

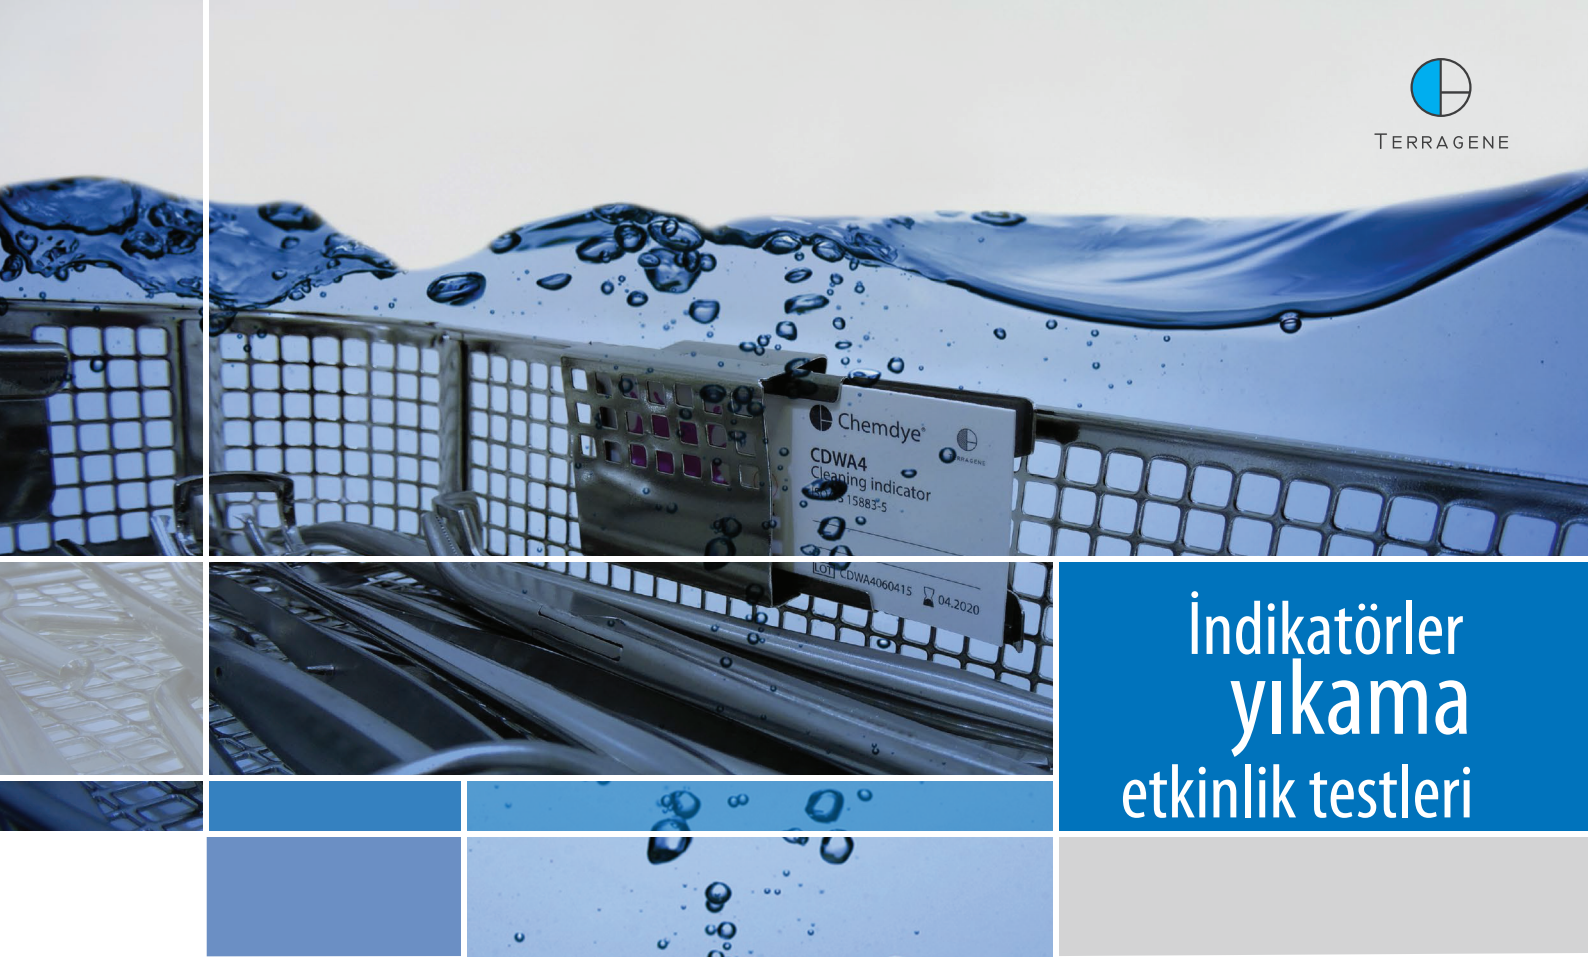

İndikatörler yıkama etkinlik testleri

Medikal alet ve malzemelerin temizlik ve yıkama süreç kontrolü son derece önemlidir çünkü sonuç sonrasında yapılan dezenfeksiyon ve/veya sterilizasyon işleminin başarısını etkiler.

Chemdye® Yıkama indikatörleri
CDWA1 CDWA2 CDWA3 CDWA4

Termodezenfektör makineleri için yıkama indikatörleri sıcaklığı stabil olan 70 x 30 mm sentetik destekten oluşur. İndikatörler özel olarak kombine edilmiş renkli organik bileşenlerdir. CDWA indikatörlerin formülasyonu temizlik / yıkama işlem sonucunu etkileyen tüm faktörleri tespit eder. CDWA indikatörleri temizlik işlemlerinin rutin takibinde kullanılabilir ve farklı yıkama ve termodezenfeksiyon konfigurasyonlarına göre otomatik makinelerdeki yıkama etkinliğini izler.
CDWA yıkama sistemi farklı yapışma karakteristiklerine göre 4 farklı seviye sunarak yıkama etkinliği için farklı zorluklar gerçekleştirmesine imkan tanır.
CDWA'nın 4 tipi de ISO/TS 15883 bölüm 5'te verilen test numunelerine göre valide edilmiştir.

Avantajlar

- Depolama esnasında yapışma ve polarite özellikleri değişebilen doğal numune düzeneklerine karşı sabit temizleme özellikleri sunar
- İndikatör toksik değildir.
- Yıkama sürecindeki hataları açığa çıkararak yüksek düzeyde güvenirlik sağlar.
- Organik formülasyona sahip olduğundan uzun raf ömrüne sahiptir.

Yıkama yok



Kısmi yıkama



Tam yıkama





Kod	Numune rengi	Zorluk seviyesi
CDWA1	Sarı	Düşük
CDWA2	Yeşil	Orta
CDWA3	Mavi	Yüksek
CDWA4	Pembe	Çok yüksek

Sipariş bilgisi

Ürün kodu	Görünüm	Açıklama	Kut başı adet	Paket
CDWA4		Yıkama performans testleri için yıkama indikatörü Zorluk seviyesi çok yüksek. Yıkama işlem sonucunu etkileyen tüm faktörler tespit eder. Ebat: 70 x 30 mm. İlk renk: Pembe Sonuç: Pembe organik maddelerin eliminasyonu.	200	
CDWAH		CDWA için Tutaç, paslanmaz çelik tekrar kullanılabilir, yüksek direnç ve sağlamlık Taban: 32 mm en, 72 mm uzunluk, arka tarafı iğneli Sepet: 32 mm en, 37 uzunluk, 7 mm kalınlık.	1	

*Every effort has been made to ensure that the information in this flyer is correct at the time of going to press. Products described herein are subject to continuous development and improvement. Terragene® reserves the right to change these at any time. Actual colors may vary.